


Из полярной истории разработки физиотерапевтического аппарата

В советское время для полярников, организм которых испытывал значительные нагрузки в условиях Крайнего Севера, требовались эффективные методы физиотерапевтической поддержки. Холод, перепады давления, особенности климата влияли на состояние сердечно-сосудистой системы. Сосуды реагировали на холод спазмами, организм повышал давление, увеличивалась вязкость крови. Плюс влияние магнитных бурь, нарушений сна и кислородного голодания.

Внимание исследователей привлекли записи из дневников экспедиций 1950-х годов, где описывалось комплексное воздействие природных факторов. Это загадочное природное явление описано так: в редкие ночи полного штиля, когда в небе горело северное сияние, воздух становился плотным, а приборы начинали фиксировать странную ритмичную вибрацию. Длилось это обычно недолго, но люди потом чувствовали себя значительно лучше, чем обычно. Так, будто отлично выспались. На основе этих наблюдений была сформулирована идея создания аппарата, сочетающего несколько видов физического воздействия.

В процессе разработки удалось создать прибор, объединяющий низкочастотный импульсный ток, магнитное поле, световое излучение и акустические колебания. Впоследствии разработка получила название «Мобильный спасатель». Полярники называли его «спасателем» за возможность получать помощь прямо на станциях.

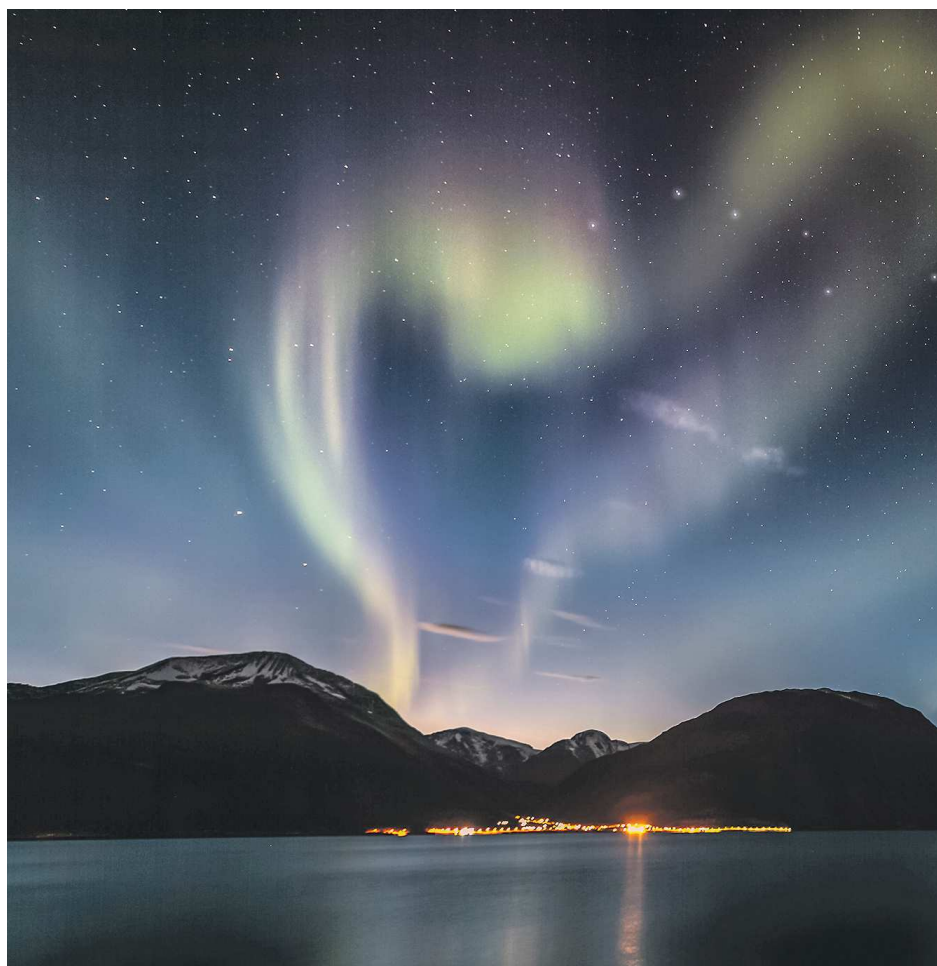

В настоящее время аппарат сертифицирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям, а также тенденция к их распространению среди различных возрастных групп показывают актуальность применения подобных аппаратов. Инфаркты и инсульты сегодня, к сожалению, стремительно молодеют, что делает задачу поддержания здоровья сосудов и сердца особенно значимой.

Аппарат имеет компактные размеры и предназначен для применения в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Он компактный и простой в использовании, так как рассчитан на самостоятельное применение, не требует специальной подготовки (подробная инструкция прилагается).

Как работает этот медицинский прибор?

В «Мобильном спасателе» конструкцией предусмотрены четыре вида воздействия:

- **Электростимуляция** направлена на стимуляцию тканей, способствует активизации кровообращения
- **Магнитное поле** оказывает воздействие на текучесть крови
- **Красное монохромное излучение** способствует активизации процессов восстановления пострадавших клеток и стенок сосудов
- **Вибротерапия** оказывает воздействие на прочистку капилляров, может помочь крови доставлять питание и кислород

Сочетание данных видов воздействия соответствует конструкции изделия и описано в инструкции по применению. Такое комплексное воздействие позволяет воздействовать на различные

факторы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. Рекомендуемый курс применения – 15–20 дней по 10–20 минут в день.

При каких состояниях может применяться прибор?

Аппарат может применяться в комплексной терапии для сердечно-сосудистой системы, назначенной лечащим врачом, в том числе в период реабилитации, когда требуется дополнительная поддержка.

Позаботьтесь о своем здоровье заранее. «Мобильный спасатель» может стать надежным помощником в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

К тому же до 7 мая 2026 г. этот медицинский прибор можно получить по минимальной цене от производителя. Для этого позвоните по телефону 8-800-300-77-70 и сообщите номер специального предложения 9632. При обращении специалисты помогут вам и ответят на все интересующие вопросы о медицинском приборе «Мобильный спасатель».



Медицинский прибор

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.